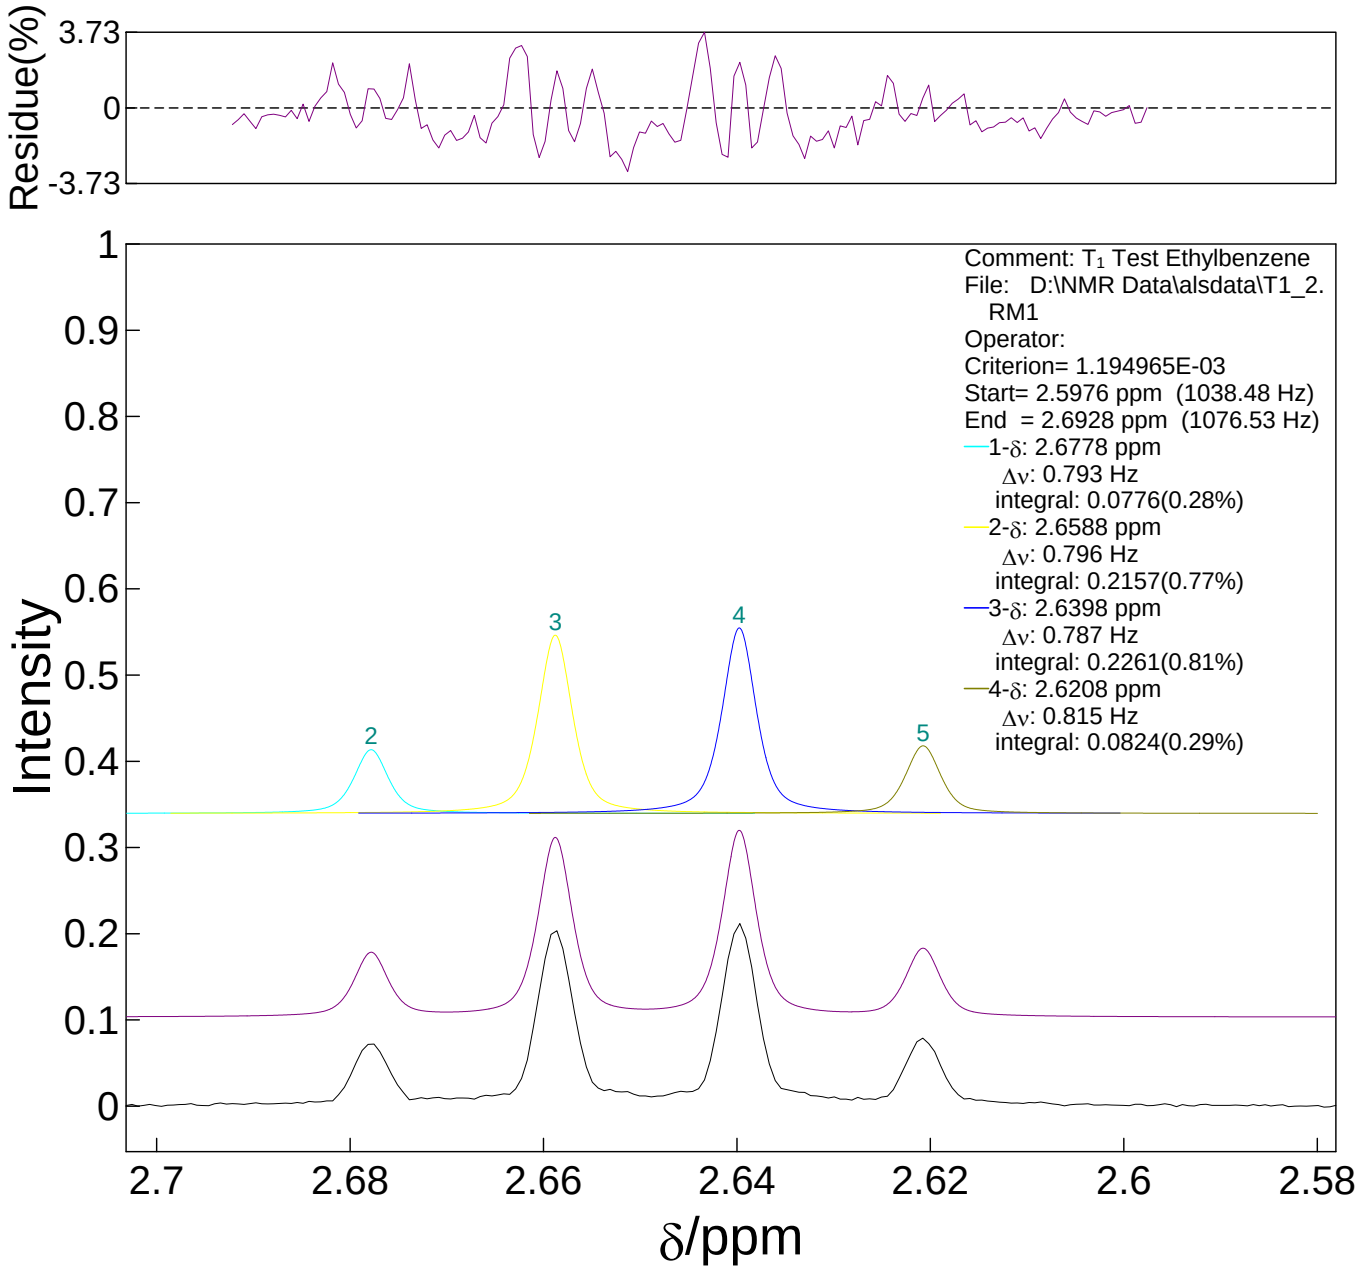
Residue(%)
3.73
0
-3.73
Intensity
1
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
2
3
4
5
Comment: T1 Test Ethylbenzene
File: D:\NMR Data\alsdata\T1_2.RM1
Operator:
Criterion= 1.194965E-03
Start= 2.5976 ppm (1038.48 Hz)
End = 2.6928 ppm (1076.53 Hz)
1-δ: 2.6778 ppm
Δν: 0.793 Hz
integral: 0.0776(0.28%)
2-δ: 2.6588 ppm
Δν: 0.796 Hz
integral: 0.2157(0.77%)
3-δ: 2.6398 ppm
Δν: 0.787 Hz
integral: 0.2261(0.81%)
4-δ: 2.6208 ppm
Δν: 0.815 Hz
integral: 0.0824(0.29%)
2.7
2.68
2.66
2.64
2.62
2.6
2.58
δ/ppm